

ДОГОВОР

№ 2250

Днес, 09.11. 2015г., в гр. София между:

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, район Люлин, ж.к. „Люлин“ 2, бул. "Панчо Владигеров" № 66 с ЕИК 175203478, представлявано от Георги Кирилов Гегов – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

"БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н Младост, бул. "Цариградско шосе" № 133, бл. БИЦ Изот, ет.6, оф.616а, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 103327353, представлявано от Камен Динков Желев - Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от една страна, и

на основание чл.41 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № БТГ-РД-07-23Б/20.05.2015 г. на Изпълнителния директор на "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД за определяне на Изпълнител на обществената поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газхроматографи и принадлежности към тях“, се сключи настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продава, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ купува 3 броя газхроматографи и принадлежности към тях, наричани за краткост в договора "оборудване", конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, количество, качество, комплектност и цена, съгласно следните приложения, представляващи неразделна част от договора:

- Приложение № 1 – Пълно описание и техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.2. След доставката на оборудването специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под ръководството на специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да извършат монтаж, пускане в експлоатация и настройка на параметрите на доставената оборудване.

II. КАЧЕСТВО, ОПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО.

2.1. Качеството и техническите параметри на оборудването трябва да съответстват на техническите изисквания по Приложения № 1 и 2.

2.2. Опаковката на подлежащото на доставка оборудване, трябва да го предпазва от повреди по време на транспортирането му до мястото на доставка, както и да обезпечава безаварийното му натоварване и разтоварване.

2.3. Количеството и окомплектовката на оборудването трябва да съответства на Приложения № 1 и 2 .

III. ЦЕНА.

3.1. Цената за изпълнение предмета на договора е в размер на 358 701.00 (триста петдесет и осем хиляди седемстотин и един) лева без ДДС и включва:

- а) стойността на оборудването, съгласно единичните цени, посочени в Приложение № 3;
- б) стойността на монтажа, пускането експлоатация и настройката на оборудването;
- в) транспортните разходи до мястото на доставка по т. 5.1;
- г) всички дължими във връзка с доставката мита, данъци и такси и др.
- д) разходите, съгласно т.5.2.4 от договора

3.2. Цената по т. 3.1. е определена при условия на доставка **DDP (съгласно Инкотермс-2010)**, с място на доставка - **Централна складова база на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в с. Яна община Кремиковци, гр. София.**

3.3. Цената по т. 3.1. е окончателно определена, не подлежи на промяна и е валидна до пълното изпълнение на предмета на настоящия Договор.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1, както следва:

4.1.1. Плащане в размер на **90% от цената по т.3.1. лева без ДДС** в срок до 10 работни дни след доставката на оборудването и представяне на следните документи и софтуерни продукти:

- а) Оригинална фактура за дължимата сума;
- б) Приемно-предавателен протокол по т.5.4., подписан от представители на двете страни, удостоверяващ съответствието на доставената оборудване с договорените изисквания;
- в) Декларации за съответствие, издадена от производителя на оборудването, по:
 - Директива 2004/108/ЕО за електромагнитна съвместимост, заменяща Директива 89/336/ЕИО;
 - Директива 94/9/ЕО (ATEX) относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера.
- г) Инструкции на хартиен (общо 4 идентични екземпляра на английски и български език) и цифров (1 екземпляр) носители, които да съдържат:
 - указания за безопасно пускане в действие, експлоатация, монтаж и демонтаж, обслужване и аварийен ремонт, инсталиране, настройка;
 - указания за обучение, което по преценка на производителя на оборудването, трябва да бъде извършено.
 - ограничителни стойности на електрически параметри, налягане, максимални повърхностни температури;
 - специални условия на експлоатация, вкл. информация за възможно неправилно използване, установено въз основа на опита;
 - технически данни за елементите, с които е комплектуван газхроматографа.
- д) Софтуери за диагностика, тест и калибриране;
- е) Монтажни схеми и P&I диаграми на системата, необходими за пускането в действие, поддържането, контрола, проверката на правилната експлоатация, за ремонта и всички други полезни указания.
- ж) Тест-протоколи от изпитване на точност с еталонен природен газ за доставените газхроматографи от производителя.
- з) Сертификати за калибриране от акредитирана лаборатория.

4.1.2. Окончателно плащане в размер на 10 % от цената по т.3.1. **лева без ДДС**, в срок до 10 работни дни след извършен монтаж и пускането в експлоатация и настройка на параметрите на цялото доставено оборудване и след представяне на следните документи:

- а) оригинална фактура за дължимата сума;
- б) констативни протоколи за извършения монтаж, настройка и пускане в експлоатация на доставеното оборудване.

4.1.3. В случай, че в срока по т.5.3.2 от договора Възложителят не е изпратил до

Изпълнителя уведомяването за монтаж на оборудването, окончателното плащане по т.4.1.2. се извършва в срок до 10 работни дни след изтичане на срока по т.5.3.2 и представяне на оригинална фактура за дължимата сума и документите по т. 4.1.2., буква „в“ от договора.

4.1.4. Извършено плащане при условията на т. 4.1.3. не освобождава Изпълнителя от задълженията му за монтаж, настройка и пускане в експлоатация на доставеното оборудване, съгласно условията на договора, като в този случай Възложителят си запазва правото да възложи тези дейности в рамките на гаранционния срок на оборудването.

V. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА И МОНТАЖ. РИСК.

5.1. Място на доставка на оборудването е **Централна складова база на Възложителя в с. Яна община Кремиковци, гр. София.**

5.2. Места за извършване на дейностите по монтаж, пускане в експлоатация и настройка на доставеното оборудване са:

- ГРС до ТЕЦ Север-Пловдив – в близост до гр. Пловдив.
- ГИС Ихтиман – в близост до с.Стамболово, община Ихтиман.
- ГИС Лозенец – в близост до с.Лозенец, община Стралджа.

5.2.1. Монтажът на оборудването в посочените по-горе места се извършва от специалисти на възложителя под ръководството на специалисти на изпълнителя.

5.2.2. Възложителят си запазва правото да промени изброените места за извършване на дейностите по монтаж, като посочи друг свой обект/и на територията на Република България.

5.2.3. Възложителят осигурява транспортирането на доставеното оборудване до съответните места за монтаж.

5.2.4. Всички разходи свързани с транспорт, престой, командировъчни и други за специалистите на Изпълнителя, които ще извършват монтажа, са за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение предмета на договора е, както следва:

5.3.1. Срок за доставка на цялото оборудване и предаване на техническата документация и софтуерни продукти - 140 дни, считано от датата на подписване на договора;

5.3.2. Срок за извършване на монтаж и пускане в експлоатация на доставеното оборудване – в рамките на 5 работни дни след получаване на писмено уведомление от Възложителя, като уведомленията за отделните обекти за извършването на монтажа ще бъдат изпратени от Възложителя не по-късно от 90 дни от датата на доставка на оборудването по т.5.4.

5.4. Предаването и получаването на оборудването и прехвърлянето на собствеността в мястото на доставката, ще се извършва и удостоверява с **приемо-предавателен протокол**, подписан от представители на страните по договора.

5.5. В рамките на гаранционния срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено, когато има готовност да се извърши монтажа и пускането в експлоатация на доставеното оборудване, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да извърши дейностите в срока по т. 5.3.2.

5.6. Монтажът на доставеното оборудване и пускането в експлоатация се удостоверява с **констативен протокол**, съставен и подписан от представители на страните по този договор.

5.7. Рискът от случайно погиване или повреждане на оборудването, преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в мястото на доставка, след предаването му с приемо-предавателния протокол по т. 5.4.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

6.1.1. да достави в срок оборудването, съответстващо по вид (търговска номенклатура),

технически данни, количество, качество, комплектност и цена, съгласно договора и приложенията към него, представляващи неразделна част от договора;

6.1.2. да ръководи специалисти на Възложителя в монтажа, пускането в експлоатация и настройката на доставеното оборудване по начин, обезпечаваш функционирането му по предназначение, в съответствие с целите на настоящия договор и приложенията към него;

6.1.3. да спазва изискванията на пропускателния режим на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6.1.4. да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора;

6.1.5. да спазва изискванията за охрана и безопасност на труда;

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

6.2.1. да приеме доставеното оборудване и извършените работи по реда и при условията на настоящия Договор и приложенията към него;

6.2.2. да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

6.3.1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на поръчката.

6.3.2. да упражнява контрол върху изпълнение на поръчката, като с това не пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ.

7.1. Гаранционните срокове на конкретното оборудване по повод проявени дефекти при използването на оборудването е 24 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т. 5.4.

7.2. Във връзка с доставеното оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че същото е ново, неизползвано и е в пълно съответствие с техническите и качествените изисквания, определени с настоящия договор и приложенията към него.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод на:

- Количеството, некомплектност и видими недостатъци на доставеното оборудване;
- Скрити недостатъци на оборудването;
- Некачествен монтаж;
- Проявени дефекти при експлоатация на оборудването в гаранционните срокове.

7.4. Рекламациите по повод количеството, комплектността и видими недостатъци на доставеното оборудване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява в срок до 10 (десет) дни след датата на подписване на протокола по т. 5.4.

7.5. Рекламации по повод скрити недостатъци, несъответстващо качество на оборудването, некачествен монтаж, настройка и/или проявени дефекти при използването на оборудването ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява в рамките на гаранционния срок по т. 7.1. и до 30 (тридесет) дни след изтичането му (при условие, че поводът за рекламация е констатиран в рамките на гаранционния срок).

7.6. Всички рекламации по настоящия договор се доказват с констативни протоколи, подписани от съответните технически специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържащи искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора и причината за рекламациите.

7.7. При рекламация по т. 7.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 10 дневен срок от получаването на констативния протокол по т. 7.6. да проучи естеството и характера на обявения недостатък/несъответствие и в срок, не по-дълъг от 20 дни от получаването на констативния протокол, на свой риск и за своя сметка да замени част или цялото оборудване с ново.

7.8. При рекламация по т. 7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка ще отстрани обявения недостатък/несъответствие в срок не повече от 45 дни от деня на получаване на протокола по т.7.6.

7.9. Гаранционният срок на оборудването се удължава с времето, през което същото е било извън експлоатация, поради проявен дефект.

7.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по този Раздел и по отношение на замененото или ремонтираното оборудване или част от него.

7.11. Рисковете и разходите, свързани с транспорта във връзка с изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Раздел ще са за негова сметка.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

8.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в една от следните форми:

а) Депозит на парична сума в размер на 5 % от сумата по т. 3.1. за срок 1 (един) месец след изтичане на гаранционния срок на доставеното оборудване, по една от следните банкови сметки на "Булгартрансгаз" ЕАД в "УниКредит Булбанк" АД, пл. "Света Неделя" № 7, София 1000, BIC код: UNCRBGSF, банкови сметки: IBAN в лева: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01; в евро: BG88 UNCR 7630 1476 0610 42.

б) Банкова гаранция в лева в размер на 5 % от сумата по т. 3.1. със срок на валидност 1 (един) месец след изтичане на гаранционния срок на доставеното оборудване.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи частично или напълно гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при неизпълнение от негова страна на някое от задълженията му по настоящия договор.

8.3. Разходите по откриването на депозита или банковата гаранция по този раздел, както и тези по евентуалното усвояване на банковата гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.4. При гаранция за изпълнение, представена под формата на депозит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през което сумата по гаранцията е законно престояла при него.

8.5. Банковата гаранция по т. 8.1., буква "б" трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията следва да съдържа задължение на Банката-гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено поискване от "Булгартрансгаз" ЕАД, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си, в съответствие с определеното в договора.

8.6. За обезпечаване задълженията за доставка и монтаж на оборудването е предназначена част от гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 3 % от сумата по т. 3.1. от договора, която се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 дни след извършване на дейностите по т. 6.1.2. от договора на цялото количество оборудване, съгласно условията на настоящия договор като в случай, че гаранцията е под формата на Банкова гаранция в този срок Възложителят се задължава да изпрати до Банката издател уведомление за намаляването ѝ с посочения размер освен, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата изцяло или част от нея, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с договореното.

8.7. За обезпечаване задълженията за гаранционна поддръжка е предназначена част от гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 2 % от сумата по т. 3.1. от договора, която се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се освобождава/ връща 1 (един) месец след изтичане на гаранционния срок на доставената оборудване, ако до датата на изтичане на гаранционния срок не са предявени искове за усвояване изцяло на сумата или част от нея по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с договореното.

8.8. Гаранцията за изпълнение не се освобождава изцяло или частично в посочените по-горе проценти, освен в случаите по т.8.2.

IX. САНКЦИИ.

9.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави и/или не монтира и пусне в експлоатация оборудването, а също и ако не представи съпътстващата го (изискуема) техническа документация, съгласно условията на договора, в сроковете по т. 5.3., същият дължи на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,1% от цената на недоставеното оборудване/ оборудването, което не е монтирано или пуснато в експлоатация за всеки ден закъснение.

9.2. Ако при рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по Раздел VII, в установените за това срокове, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% от цената на оборудването, за което е направена рекламацията, за всеки ден закъснение.

9.3. При начислена неустойка за забава, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне начислената неустойка от дължимото плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да усвои гаранцията за изпълнение, открита по раздел VIII, а ако гаранцията е в по-малък размер от дължимата неустойка, разликата между двете суми е платима по банков път от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни след представянето на оригинална фактура за дължимата сума.

9.4. При забава в плащането на дължима по т. 3.1 сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума, за всеки ден закъснение.

9.5. Всяка от страните може да претендира по общия ред обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техният размер надвишава неустойката по този Раздел.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

10.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Страна по договора, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора, не може да се позовава на непреодолима сила по отношение на тях. Някоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава.

10.2. Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.

10.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради настъпила непреодолима сила, в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на настъпване на събитието уведомява другата страна за това обстоятелство. В 15 (петнадесет) дневен срок от датата на настъпване на събитието, с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати Справка (*писмено потвърждение*), изходящо от официален орган (*съответна Търговско-промишлена палата*), в което да се посочи причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на поръчката.

10.4. Писмено уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на непреодолимата сила в 7-дневен срок от датата на прекратяване на събитието. При неуведомяване не може да има позоваване на непреодолима сила.

10.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове по договора за изпълнение на поръчката се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

10.6. Ако непреодолимата сила продължи повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни и някоя от страните вече няма интерес от изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15-дневно предварително писмено уведомление до другата страна.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

- с изпълнение на задълженията от всяка от страните;
- по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- едностранно от изправната страна при неизпълнение на задълженията по договора от другата страна, с 15 дневно писмено предизвестие
- при условията на т.10.6.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

XII. ПОДСЪДНОСТ.

12.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор - по повод изпълнението или тълкуването му, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решават чрез договаряне помежду си.

12.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те ще подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съд в Р. България.

XIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

13.1. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

13.2. Във връзка с изискванията за достъп до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че в представения Списък с лицата, които ще извършват дейностите предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил лице, за което след извършена проверка от ДАНС излезе отрицателно становище, за същото няма да бъде издаден достъп до обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 /десет/ работни дни от получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отказания достъп на лицето, да представи необходимите документи за друг специалист с еквивалентен опит, с оглед осигуряване на неговия достъп до обекта.

13.3. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с договора се извършват в писмена форма (факс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба).

13.4. Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

13.5. Неразделна част от настоящия договор са цитираните в **Раздел I** Приложения.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ГЕГОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

КАМЕН ЖЕЛЕВ
УПРАВИТЕЛ





ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газхроматограф и принадлежности към него

Идент. номер на поръчката:

140-144

Настоящият документ съдържа пълното описание на предмета на поръчката, техническата спецификация и условията и изискванията към изпълнението на предмета на поръчката.

1. Основна цел:

Настоящата доставка на три газхроматографа е предназначена за измерване на качествените параметри – компонентен състав на природния газ транспортиран по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Газхроматографите са код съгласно общия терминологичен речник **CPV - 38432210-7**.

На база измерения състав на газа да се изчислява горната и долната граница на топлината на изгаряне (калоричност), определени при референтна температура на изгаряне 298.15 K (25 °C) и стандартни условия за измерване на обема на природен газ 293.15 K (20 °C).

2. Изисквания относно документите, които се представят при офертата:

2.1 За газхроматографите да има декларации за оценено съответствие със съществените изисквания по:

2.1.1 Директива 89/336/CE за електромагнитна съвместимост;

2.1.2 Директива 94/9/EO (ATEX) относно оборудването и защитените системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера;

2.2 Техническа документация на хартиен и цифров носители, която да бъде представена на оригиналния език, на който е изготвена от производителя и в превод на български език, и която да съдържа информация за:

2.2.1. Работните условия;

2.2.2. Класовете за механични и електромагнитни условия на околната среда;

2.2.3. Горната и долната граница на температурата на околната среда и измерваната среда;

2.3. Списък на лицата /собствен или привлечен персонал/ удостоверяващ квалификацията им за монтаж и пуск на доставеното оборудване.

2.4. Оторизационен документ от производителя на предлаганата стока, че участника е оторизиран да извършва за същата монтаж и пускане в експлоатация и/или сервиз.

3. Изисквания относно документите, които следва да се представят при изпълнение на договора:

3.1 Декларация за съответствие по:

3.1.1. Директива 89/336/CE за електромагнитна съвместимост;

3.1.2. Директива 94/9/EO (ATEX) относно оборудването и защитените системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера;

3.2 Инструкции на хартиен (4 идентични екземпляра на английски и български език) и цифров (1 екземпляр) носители, които да съдържат:

3.2.1. указания за безопасно пускане в действие, експлоатация, за монтаж и демонтаж, обслужване и аварияен ремонт, инсталиране, настройка и експлоатация;



- 3.2.2. указания за обучение, ако е необходимо;
- 3.2.3. ограничителни стойности на електрическите параметри, налягане, максимални повърхностни температури;
- 3.2.4. специални условия на експлоатация, вкл. информация за възможно неправилно използване, установено въз основа на опита;
- 3.2.5. технически данни за елементите, с които е комплектован газхроматографа;
- 3.2.6. Описание на комуникационните параметри и регистрите на MODBUS RTU.
- 3.3. Софтуер за диагностика, тест и калибриране.
- 3.4. Монтажни P&I диаграми на системата, необходими за пускането в действие, поддържането и контрола, проверката на правилната експлоатация, за ремонта и всички други полезни указания.
- 3.5. Тест-протокол за изпитване на точност с еталонен природен газ за доставения газхроматограф от производителя.
- 3.6. Сертификат за калибриране от акредитирана лаборатория.

4. Технически изисквания към изделието:

- 4.1 Газхроматографите да са нови, неупотребявани с нанесени следните маркировки и означения:
 - 4.1.1. Маркировка за съответствие;
 - 4.1.2. Специфична маркировка за експлозивна защита, следвана от означения за групата категорията и за експлозивна смес на разходомерите за газ, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера;
 - 4.1.3. Маркировка (ограничителни стойности на електрически параметри, налягане, максимални повърхностни температури), указваща че Газхроматографа е изпитан съгласно европейските хармонизирани стандарти за употреба в експлозивна атмосфера;
 - 4.1.4. Означение за степента на защита по IEC 60529 от проникване на твърди частици и течности.
 - 4.1.5. Търговска марка или наименование на производителя;
 - 4.1.6. Информация за условията на използване (налягане; температура на околната среда, температура на измерваната среда – природен газ, данни за основните допустими максимални и минимални гранични стойности на параметрите);
 - 4.1.7. Означения за идентификация;
 - 4.1.8. Идентификационните номера на нотифицираните органи, извършили оценяване на съответствието с приложимите съществени изисквания.

5. Място на доставка:

- 5.1. Място на доставка - Централна складова база на Булгартрансгаз ЕАД в с. Яна община Кремиковци, гр. София.

6. Място на монтаж и пускане в експлоатация:

- 6.1. ГРС до ТЕЦ Север-Пловдив – в близост до гр. Пловдив.
- 6.2. ГИС Ихтиман - в близост до с. Стамболово, общ. Ихтиман
- 6.3. ГИС Лозенец - в близост до с. Лозенец, общ. Стралджа

7. Срок за доставка:

Срок за доставка - не повече от 180 дни.

8. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка:

Гаранционен срок трябва да бъде не по-кратък от 24 месеца или не по-дълъг от 60 месеца от датата на доставката.

Изготвил:

Христо Христов – ръководител отдел "Метрология, ГРС"- лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП, а именно умения, усвоени в процеса на упражняване на основните трудови задължения на специалиста съгласно длъжностната му характеристика.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката: **Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газхроматограф и принадлежности към него**

Идент. номер на поръчката: **140-144**

1. Изисквания към газхроматографа (код CPV - 38432210-7):

1.1. Количество	3 броя
1.2. Анализирани газ	Природен газ
1.3. Принцип на измерване	Газова хроматография
1.4. Хроматографски метод	ISO 6974 part 4
1.5. Метод за изчисляване на горна граница на топлина на изгаряне	ISO 6976, ISO12213
1.6. Цикъл на измерването	< 6 минути
1.7. Повторяемост	+/- 0,05% от калоричното число
1.8. Анализирани компоненти	C ₁ до C ₆ +, N ₂ , CO ₂
1.9. Изчисляване на	Топлина на изгаряне, плътност и свиваемост
1.10. Степен на защита	EEx d IIC T4; IP65
1.11. Маркировка CE Mark	Electromagnetic compatibility (89/336/CE) ATEX (94/9/CE)
1.12. Околна температура	-10 до +50°C
1.13. Работна температура	0 до 40°C
1.14. Комуникации	1 порт RS232 или RS485 за предаване на данни; 1 порт RS232 или RS485 или USB за конфигурация, контрол и поддръжка от PC с необходимия софтуер, работещ под Windows 7 x64, x32 и Windows 8 x64, x32; Портовете да поддържат MODBUS RTU комуникационен протокол. Да се предостави пълно описание на регистрите му.
1.15. Захранване	24 V DC +/-15% със захранващ блок 220 V AC

2. Газхроматографът да е окомплектован със

- 2.1. Отопляема пробоотборна система, редуктор на налягане и изолирана импулсна линия 10 m;
- 2.2. Шкаф с всички необходими елементи за работа в автоматичен режим и автокалириране;
- 2.3. Комплекти тръбни връзки до бутилки с еталонен газ и носещ газ (хелий) с редуцир вентил и манометър;
- 2.4. Бутилка с еталонен газ, отговарящ на изискванията на – min 10 l, min 40 bar, отговаряща на изискванията „CE“ маркировка и сертификат за газа по ISO 6141 от акредитирана лаборатория
- 2.5. Бутилка с носещ газ Хелий 5.0 – min 50 l, min 200 bar, отговаряща на изискванията „CE“ маркировка и сертификат за газа;
- 2.6. Газхроматографът да се достави със софтуер за диагностика, тест и калибриране.
- 2.7. Захранващ блок 220V 50Hz – 24V отговарящ на изискванията на газхроматографа и средата в която ще се монтира.


3. Компоненти за анализиране.

Компонент	Концентрация (mol%)
Sum C6+	0-0,5
C3H8	0-5
i-C4H10	0-1
n-C4H10	0-1
Neo-C5H12	0-1
i-C5H12	0-1
n-C5H12	0-1
N2	0-15(0-8)
CH4	50-100
CO2	0-10
C2H6	0-10

4. Състав и параметри на анализирания природен газ:

Формула	Концентрация	Мерна единица
CH4	> 92	% mol
C2H6	< 4	%
C3H8 + C4H10 + други тежки въглеводороди	< 2	%
N2	< 2	%
CO2	< 1	%
Налягане на газа	20 до 54 bar	
Температура на газа	зима +3°C / лято +18°C	
Температура на околната среда	-20 до +50 °C	
Влажност на атмосферния въздух	0 - 95% RH	

Изготвил:


.....
Христо Христов – ръководител отдел "Метрология, ГРС"- лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП, а именно умения, усвоени в процеса на упражняване на основните трудови задължения на специалиста съгласно длъжностната му характеристика.


13/06/2011



Наименование на участника: „Брайт Инженеринг“ ООД

Посочва се:

- фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
- когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната форма в случай, че има такава

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газхроматографи и принадлежности към тях

Идент. номер: 140-144

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. пълното описание на предмета на поръчката и приложенията към него.

1. Ще изпълним от предмета на поръчката следното:

- Доставка на газхроматографи
- Контрол върху монтажа на газхроматографи
- Пускане в експлоатация на газхроматографи

Описват се доставките, които ще бъдат осъществени и се посочва производителят/ите на съответното оборудване.

2. Предлаганите от нас доставки са подробно описани в приложение № 1 към настоящото техническо предложение.

3. Срок на доставка на стоката - 140 дни (не повече от 180 дни), считано от датата на подписване на договора.

3.1. Ще извършим монтаж и пускане в експлоатация на доставеното оборудване – в рамките на 5 работни дни след писмено уведомление от Възложителя в периода на гаранционния срок.

4. Гаранционен срок: 24 (не по-малко от 24 месеца и не повече от 60 месеца) месеца от датата на доставка.

5. Прилагаме следните документи:

5.1 декларации за оценено съответствие на Газхроматографа съд съществените изисквания по:

5.1.1 Директива 89/336/СЕ за електромагнитна съвместимост;

5.1.2 Директива 94/9/ЕО (ATEX) относно оборудването и защитените системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера;

5.2 Техническа документация на хартиен и цифров носители, представена на оригиналния език, на който е изготвена от производителя и в превод на български език, и която съдържа информация за:

5.2.1. Работните условия;

5.2.2. Класовете за механични и електромагнитни условия на околната среда;

5.2.3. Горната и долната граница на температурата на околната среда и измерваната среда;

5.3. Оторизационен документ от производителя на предлаганата стока, че участника е оторизиран да извършва за същата монтаж и пускане в експлоатация и/или сервиз.

Забележка: От обхвата на оторизацията следва да не е изключена територията на Република България.

6. Декларирам, че съм съгласен с начина на плащане съгласно раздел IV от проекта договора от документацията за участие.

Приложения: съгласно текста

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):

Наименование (на участник и посочване на правноорганизационна форма – „Брайт Инженеринг“ ООД

Представяващ: Камен Желев (име и фамилия)

Подпис

Представяващ: Динко Желев (име и фамилия)

Подпис

Дата 18.03.2015 г.

Документът се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Упълномощено лице (име и фамилия)

Подпис

Дата

Когато участникът няма определена правна форма:

Физически лица (изброяват се всички физически лица, които участват в обединението - име и фамилия)

Подпис/и

Представяващ/и(име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)

Подпис/и

Дата

Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението.

Упълномощено лице (име и фамилия)

Подпис

Дата

Техническа характеристика и описание на предлаганите стоки за доставка

Позиция от техническата спецификация	Описание на предлагания продукт	Модел и производител	Количество	Съответствие с изискванията на възложителя	Забележка
1	2	3	4	5	
1.	Газхроматограф с принадлежности към него	Модел: HGC303 Производител: Azbil Yamatake (Socrate)	3 броя	Отговаря напълно на техническата спецификация от ОП № 140-144	Подробно описание в Приложение №2
2.	Бутилка за еталонен газ	Производител: Линде Газ	3 броя	Отговаря напълно на техническата спецификация от ОП № 140-144	Подробно описание в Приложение №2
3.	Бутилка за носещ газ Хелий	Производител: Линде Газ	3 броя	Отговаря напълно на техническата спецификация от ОП № 140-144	Подробно описание в Приложение №2

Забележка:

- В графа № 2 следва да се посочат параметрите на предлаганото оборудване, съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация. Когато описанието по някоя от позициите е със значителен обем и/или има снимков материал, същото следва да бъде предоставено в приложение, като по-горе се посочи номера на приложението.
- В графа № 5 следва да се декларира дали предлаганото оборудване по конкретната позиция отговаря напълно на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в техническа спецификация за тази позиция.

Приложения:

1. Подробно техническо описание на Газхроматографа и принадлежности към него – Приложение №2;
2. Декларация за оценено съответствие на Газхроматографа със съществените изисквания по: Директива 2004/108/ЕО за електромагнитна съвместимост и Директива 94/9/ЕО (ATEX) относно оборудването и защитените системи
3. Каталогна информация /Техническа документация/ за Газхроматографа и принадлежностите към него – на хартиен и на електронен носител;
4. Оторизационен документ от производителя на предлаганата стока.

Съществените изискванията на възложителя

Y. K.

Y. K.

**Подробно техническо описание на предлагания
Газхроматограф и принадлежности към него**

1. Въведение

Обхватът на настоящето предложение е доставка на газхроматограф, подходящ за анализ на природен газ със следния състав и параметри:

Формула	Концентрация	Мерна единица
CH ₄	> 92	% mol
C ₂ H ₆	< 4	%
C ₃ H ₈ + C ₄ H ₁₀ + други тежки въглеводороди	< 2	%
N ₂	< 2	%
CO ₂	< 1	%
Налягане на газа	20 до 54 bar	
Температура на газа	зима +3°C / лято +18°C	
Температура на околната среда	-20 до +50 °C	
Влажност на атмосферния въздух	0 - 95% RH	

Предложеният газхроматограф е на фирма Yamatake Azbil, модел HGC 303, състоящ се от Аналитичен блок (HGC303), който ще бъде монтиран в потенциално опасната среда, и Управляващ блок (HDM303), монтиран в безопасната зона.

Аналитичният блок HGC303 е монтиран в самостоятелна ракла, подходяща за полеви монтаж.

Управляващият блок HDM303 е предназначен за монтаж в безопасна зона.

2. Газхроматограф – Yamatake Azbil

а) Полеви трансмитер: компактен и масивен дизайн за полеви монтаж.

б) Пакетно приложение за анализ на природен газ – готов за стартиране, стандартно приложение с концентрации на газови компоненти, калоричност на газа и други параметри в съответствие с ISO стандарти.

в) Fieldbus комуникация: стандарта Fieldbus Foundation е използван за ефективно предаване на данни и самодиагностика, както и за комуникация с цел конфигуриране и поддръжка.

г) Екологично съобразена конструкция: в съответствие с ISO 14001.



2.1. Аналитичен блок HGC303 – Техническа спецификация

Принцип на измерване: Газова хроматография

Цикъл на измерването: 300 секунди

Детектор: Микро детектор на топлинна проводимост (TCD = Thermal Conductivity Detector)

Хроматографски метод: ISO 6974, част 4

Повторяемост: $< \pm 0.025$ от калоричната стойност

Компоненти и минимална откриваемост:

Компоненти	Концентрация (mol%)	Минимална откриваемост (mol%)
Sum C6+	0-0.5	0.01
C3H8	0-5	0.05
i-C4H10	0-1	0.01
n-C4H10	0-1	0.01
neo-C5H12	0-1	0.01
i-C5H12	0-1	0.01
n-C5H12	0-1	0.01
N2	0-15	0.05
CH4	50-100	5
CO2	0-10	0.05
C2H6	0-10	0.05

Изходи на анализатора:

- Калоричност на газа (идеална/реална, висша/нисша)
- Плътност на газа / Относителна плътност
- Индекс на Wob
- Коефициент на свиваемост
- Обща стойност на суровия газ
- Температура на пещта (HGM)
- Налягане на носещия газ (HGM)

Допълнителни функции:

- Автокалибриране
- Нормализиране на концентрации
- Онлайн диагностика

Комуникация:

Блокът HGC303 комуникира с Fieldbus Foundation протокол към HDM303 Fieldbus / Modbus конвертор с до 2 серийни изхода измежду RS232 и RS485 или до 3 аналогови изходи (HDM303 зависимост).

Също така, към PC през HFA-100 Fieldbus/USB конвертор за конфигуриране, поддръжка и предаване на данни. PC и Fieldbus свързването е част от стандартното оборудване. Windows-базираният специфичен HGC303 софтуер, Smart Gaschro Monitor HGM, осигурява надеждно управление на HGC303 в лесна за ползване от потребителя среда.

Конструкция на прибора:

Размери: 100 x 110 x 245 mm (Ш x Д x В)



Тегло: 5 kg

Материали: Копус: отлят алуминий; Потопяеми части: 304 SS, полиамид

Сензор: платина, стъкло, злато

Цвят на копуса: светло-зелен, сребърен

Конструкция: ATEX Zone 1 EExd IIC T6

Степен на защита: IP65

CE маркировка: Електромагнитна съвместимост, ATEX (съгласно приложената декларация за съответствие)


Консумативи:

Носещ газ: Хелий, чистота 99.995 или по-добра

Налягане: 400 kPa +/- 50kPa, консумация: 50 ml/min

(приблизително, консумацията включва превключване на соленоидните вентили в газхроматографа)

Захранване: 24 V DC +/- 15%, 25 VA (при стайна температура), включен захранващ блок 220VAC към 24VDC Ex-d

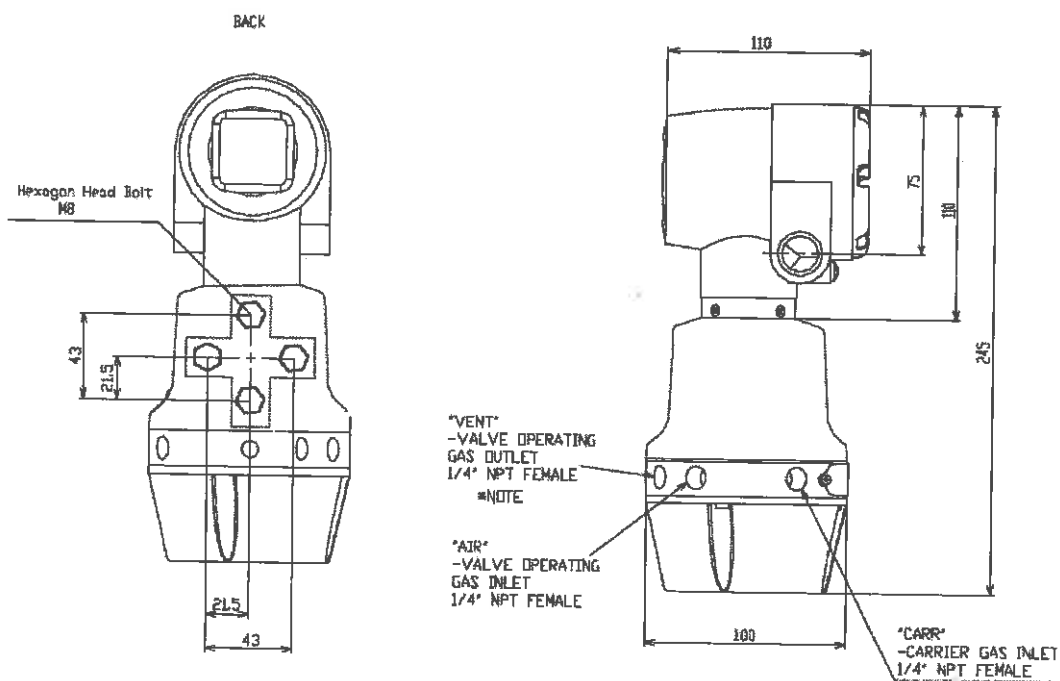


3/8



2.2. Управляващ блок HDM303 – Fieldbus към Modbus конвертор


Основни функции:

- Функция за съхранение на данни: последните 18500 записи на данни се съхраняват във вътрешната памет
- Монтаж: в безопасна зона
- Механична защита: съгласно NEMA-4X
- Захранване: 24 VDC, включен захранващ блок 220VAC към 24VDC
- Предложена конфигурация:
 - 1 сериен порт (RS485) за Modbus комуникация
 - 1 сериен порт (RS232) за Modbus комуникация

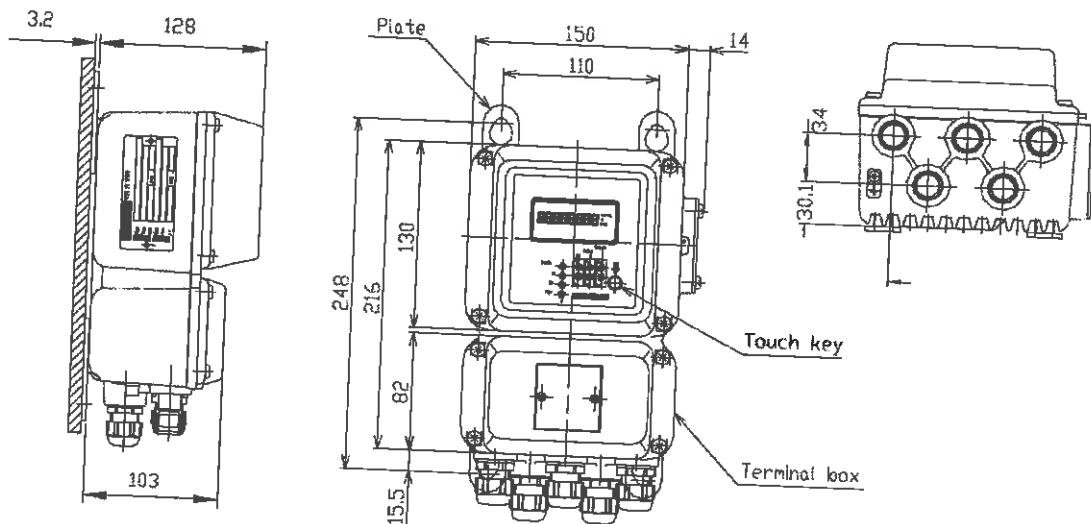

Handwritten signature


Handwritten signature

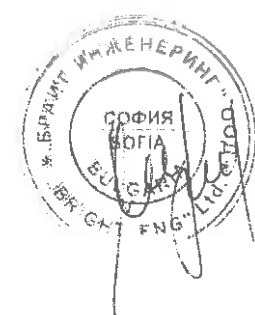

Handwritten signature

Handwritten signature

2.3. Интерфейсен блок HFA100 – Fieldbus към USB конвертор
 HGC Fieldbus Адаптор (HFA) е интерфейс, използван за свързване на газхроматографа към PC чрез използване на USB порт.

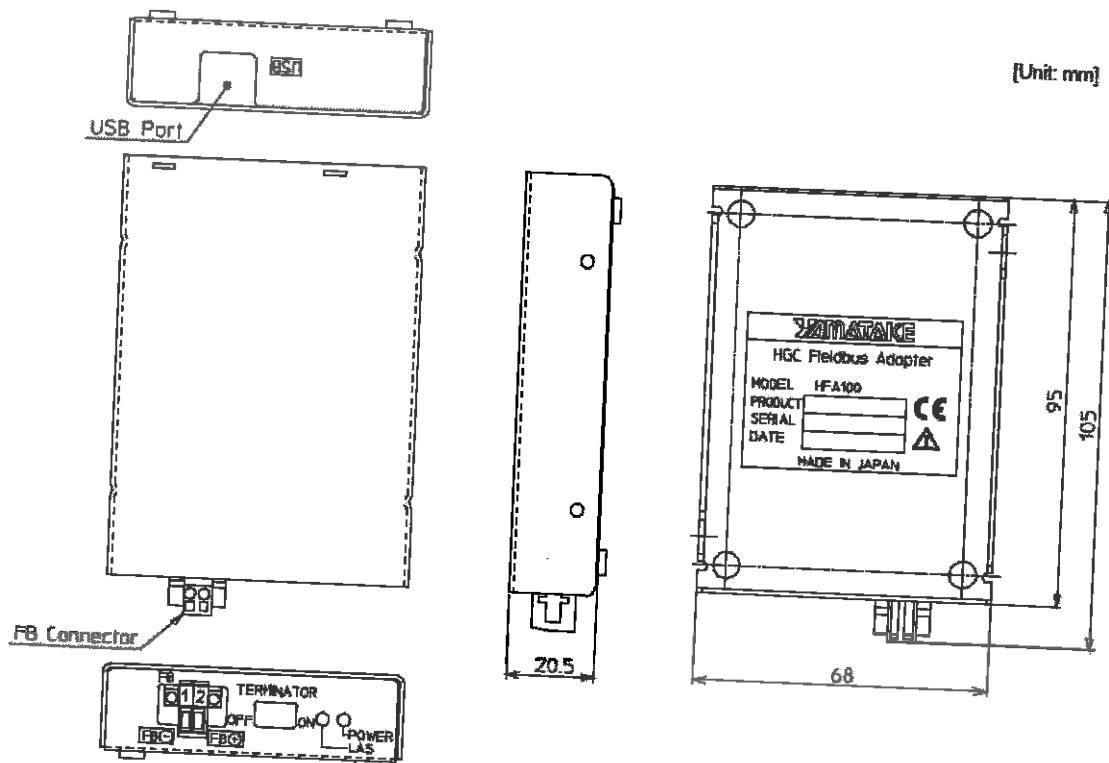

3. Пробоотборна система

Отборната система е проектирана за специфично приложение – анализ на природен газ извършвано с газхроматографи на Yamatake / Azbil.

Състои се от:

- Пробовземна сонда с редуциране на процесното налягане, монтирана на тръбопровода;
- Пробоотборна линия;
- Стандартна байпасна линия за свежа проба (fast loop system).

3.1. Пробовземна сонда с редуциране на процесното налягане (PRS)

Пробовземната сонда служи за отнемане на проба от природния газ и подаването ѝ към газхроматографа. Монтирана е посредством резба на тръбопровода. Снабдена е с редуктор за намаляване на налягането в линията до работното налягане на газхроматографа (400 kPa). Осигурява намаляване на времето за транспорт на пробата; намаляване на адсорбционния ефект на компонентите; компенсирание на температурното охлаждане при редукция на налягането на газа, вследствие на Джаул-Томпсъновия ефект.

3.2. Пробоотборна транспортна линия

Използва се изолирана електрически обогревема транспортна линия с диаметър 6 мм, материал: неръждаема стомана SS316.




3.3. Байпасна линия за свежа проба (fast loop system)

Байпасната линия за свежа проба позволява на пробата да протича от транспортната линия с по-висока скорост отколкото естествената консумация на анализатора. Пробата се изпраща през мембранен филтър чрез линията, като по този начин осигурява свежа проба и редуцира времето на закъснение на пробата, изчиствайки пробата до анализатора от всякъв конденз. Осигурен е иглен клапан за регулиране на бързия поток, който се отвежда посредством малък факел на атмосфера.

Калибрирането се извършва чрез соленоиден вентил, управляван от управляващ блок HDM303.

Байпасната линия с прилежащата контролна и измервателна арматура, заедно с газхроматографа са монтирани във вътрешността на кутия от неръждаема ламарина SS 304. В нея има взривозащитен нагревател, благодарение на който се осигурява работна температура за хроматографа от $-10...+50^{\circ}\text{C}$ при промяна на околната температура от $-20 ... +50^{\circ}\text{C}$ съгласно изискванията на заданието.

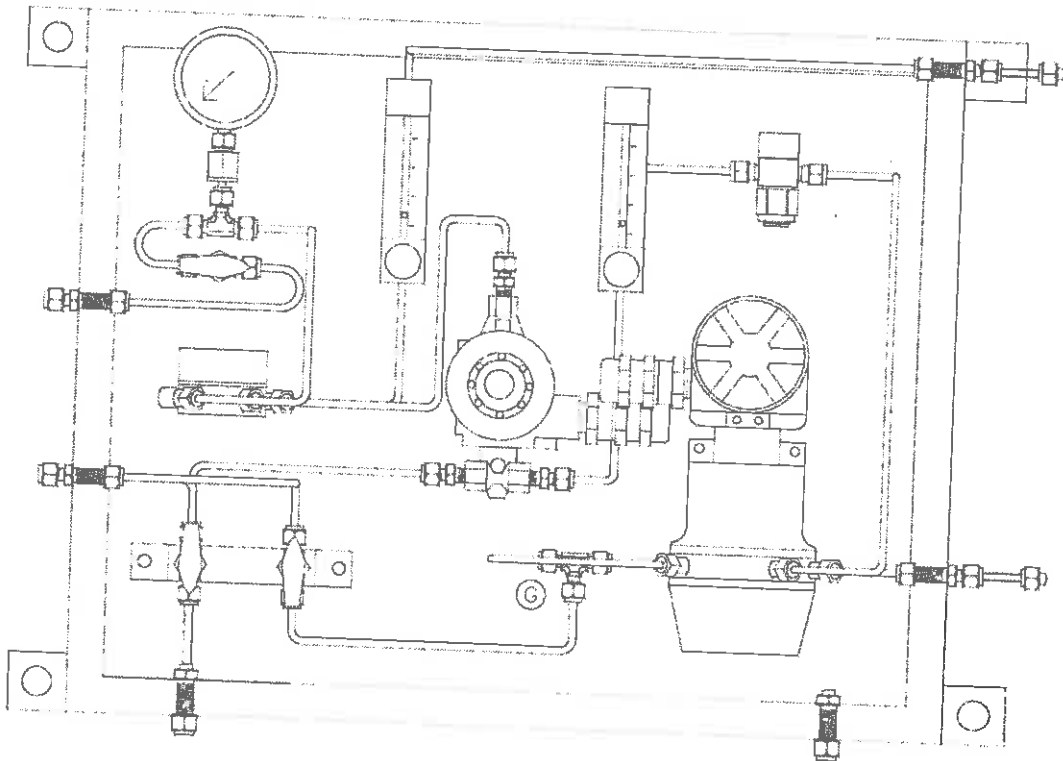


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




4. Конструкция на системата

Системата ще бъде монтирана на рамка от неръждаема стомана (SS304), включваща аналитичния блок (HGC303) и съответната байпасна линия за свежа проба. Предвиден е сенник за рамката от неръждаема стомана (SS304).


На рамката ще бъдат монтирани захранване (разпределителна кутия и ключове) и държач на бутилките.

Предвидени са 2 бутилки - една за хелий и една за калибрационен газ, монтирана в защитен шкаф и отопляема съгласно приложения чертеж.

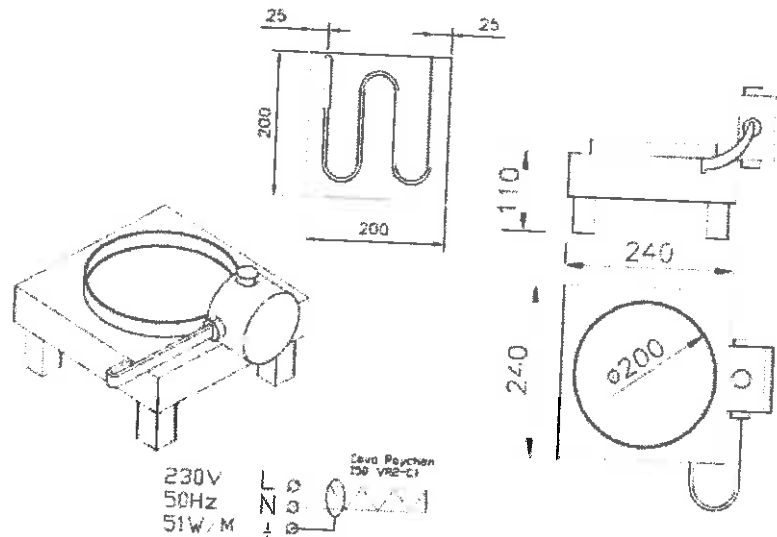

Размери на рамката : 2000 x 800 x 800



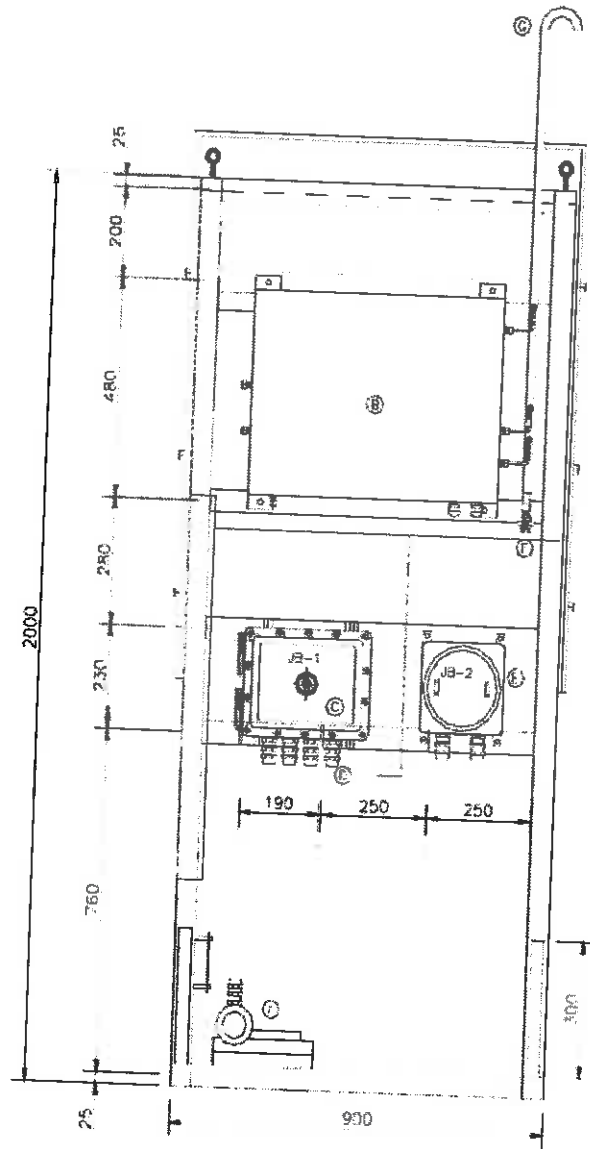

4.1. Бутилки с газ

Носещ газ: 1 х хелий с чистота 99.995 %, 200 bar , 50 lt .

Калибриращ газ : 1 х газова смес , съгласно таблицата по-долу, 70 bar, 10 lt.

Състав на калибрацията газ:

Hydrocarbons mixture composition (*):

Component	Concentration (%vol)	Tolerance
N-hexane	0.09	+/-5%
N-pentane	0.05	+/-5%
Isopentane	0.05	+/-5%
N-butane	0.2	+/-5%
Isobutane	0.14	+/-5%
Propane	0.85	+/-5%
Ethane	3.4	+/-5%
CO2	0.55	+/-5%
Nitrogen	2	+/-5%
Methane	92.67	



Наименование на участника: „Брайт Инженеринг“ ООД

Посочва се:

- фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
- когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната форма в случай, че има такава

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газхроматографи и принадлежности към тях

Идент. номер: 140-144

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на предмета на горепосочената обществена поръчка:

Цена и условия на формирането ѝ.

Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по **единични цени**, съгласно приложение № 1 към настоящото предложение, при следните условия:

- Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията за участие в процедурата.
- Всички посочени цени са в лева без ДДС.
- **Посочената цена** включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
- Условие за изпълнение на доставката е DDP по *Incoterms-2010*, с място на доставка с.Яна – Централна складова база на Булгартрансгаз ЕАД

Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на:

Цифром: 358 701.00 лева

без ДДС

Словом: триста петдесет и осем хиляди седемстотин и един лева
без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността и валутата, без ДДС)

(При публичното оповестяване, съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, на предлаганата обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от комисията за провеждане на процедурата се оповестява предлаганата обща цена, изписана словом)

- **В случай на несъответствие** между общата цена за изпълнение предмета на поръчката, изписана цифром и словом, за вярна се приема, посочената словом, като същата се оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 69а, ал. 3 от

Анита Стоянова стр.1/3





Закона за обществени поръчки (ЗОП). В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.

- При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, **валидна ще бъде общата цена на офертата изписана словом** и ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата в определен от комисията срок.
- **Посочената цена** включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.

***Забележка:**


За целите на оценяване на офертите, съгласно предварително обявения критерий „икономически най-изгодна оферта“, посочената валута на „Предлаганата цена“ от участника за изпълнение на поръчката се преизчислява в левова равностойност, съгласно посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти за участие, посочена в обявление на обществената поръчка.

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):

Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма – „Брайт Инженеринг“ ООД

Представяващ: Камен Желев (име и фамилия)

Подпис

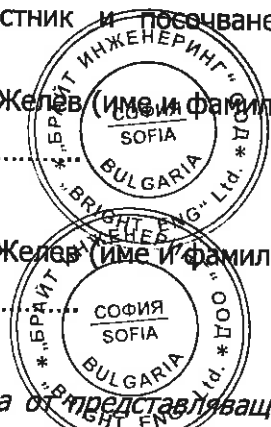

Представяващ: Динко Желев (име и фамилия)

Подпис

Дата 18.03.2015 г.

Документът се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)).

Упълномощено лице (име и фамилия)

Подпис

Дата

Когато участникът няма определена правна форма:

Физически лица (изброяват се всички физически лица, които участват в обединението - име и фамилия)

Подпис/и

Представяващ/и Камен Желев «Брайт Инженеринг» (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)

Подпис/и

Дата

Анича Стоянова

 стр.2/3

Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението.

Упълномощено лице (име и фамилия)

Подпис

Дата

Този документ задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.

Приложение №1

Описание на предлаганата стока	Количество	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	2	3	4
Газхроматограф с принадлежности към него	3 броя	116132.00	348396.00
Бутилка за еталонен газ	3 броя	655.00	1965.00
Бутилка за носещ газ Хелий	3 броя	2780.00	8340.00
Обща цена за изпълнение на поръчката			358701.00

Handwritten signature

Ангела Гюнюва

Handwritten signature

стр.3/3

Handwritten signature